

Firmy biorące udział w postępowaniu opublikowanym w BZP e – Zamówienia: ogłoszenie nr 2022/BZP 00368184/01 z dnia 2022-09-28 i na stronie internetowej <https://www.zoz.konskie.bip.org.pl>, <https://miniportal.uzp.gov.pl/>

Dot: przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy przez okres 12 – miesięcy sprzętu medycznego jednorazowego użytku i materiałów zużywalnych w Stacji Dializ – wg zadań od 1 do 9

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące wnioski dotyczące treści zapisów SWZ informuje :

I.

Pytanie 1:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 8 cewników naczyniowych do hemodializy krótkoterminowej 12F w dostępnych długościach:

poz. 1) 150, 200 i 240mm – proste;

poz. 2) 150 i 200mm - zakrzywione;

poz. 3) 150 i 200mm – zakrzywione.

ODP: Nie. Zgodnie z zapisami SWZ

II.

Pytanie nr 1 – dotyczy Zadania nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu nieznacznie różniącego się od opisanego w SIWZ, który bez zastrzeżeń stosowany jest przez największe stacje dializ w Polsce?

Skład:

Ilość

Część A "Podłączenie":

- Plaster włókninowy 2,5 x 15,5cm, 4 paski
- Opatrunek włókninowy do mocowania kaniul 6x8cm
- Kompresy włókninowe 7,5x7,5cm, 4w
- Serweta podfoliowana Hospidrape 38x45cm, 44g/m2
- Rękawiczki nitrylowe bezpudrowe M

1

2

6

1

2

Część B "Rozłączenie":


- Kompresy włókninowe 7,5x7,5cm, 4w
- Opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym 5x7cm
- Rękawiczka winylowa bezpudrowa L
- Rękawiczki nitrylowe bezpudrowe M

4

2

1

2

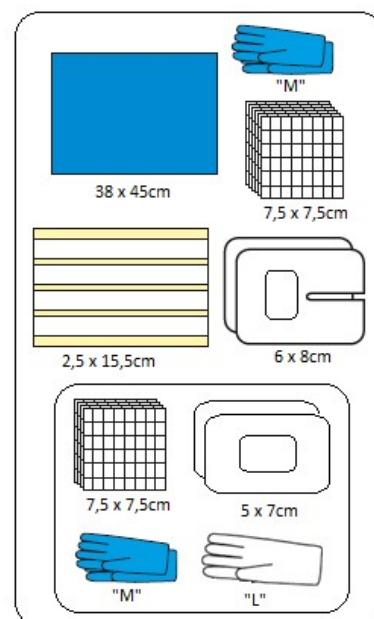

Opakowanie jednostkowe typu „zestaw w zestawie”. Część B (w oddzielnym

opakowaniu) umieszczona z pozostałymi komponentami w opakowaniu papierowo-foliowym

ODP: Nie. Zgodnie z zapisami SWZ

III.

Czy Zamawiający w zadaniu nr 2:

- w pozycji Lp.1 dopuści dializator niskoprzepływowo, heliksonowy, o powierzchni czynnej 1,8m, z klirensem fosforanów 210 przy QB 300mL/min [symbol FX10],

- w pozycji Lp.2 dopuści dializator wysokoprzepływowo, heliksonowy, o powierzchni czynnej 1,8m, z klirensem fosforanów 244 przy QB 300mL/min [symbol FX80classix] do wykonywania hemodializ,

- w pozycji Lp.3 dopuści dializator wysokoprzepływowo, heliksonowy, o powierzchni czynnej 2,2m, z klirensem fosforanów 253 przy QB 300mL/min [symbol FX100classix] do wykonywania hemodializ?

Czy Zamawiający w zadaniu nr 2:

- w pozycji Lp.1 dopuści dializator niskoprzepływowo, heliksonowy, o powierzchni czynnej 1,8m, z klirensem fosforanów 210 przy QB 300mL/min [symbol FX10],

- w pozycji Lp.2 dopuści dializator wysokoprzepływowo, heliksonowy, o powierzchni czynnej 2,2m, z klirensem fosforanów 253 przy QB 300mL/min [symbol FX100classix] do wykonywania hemodializ,

- w pozycji Lp.3 dopuści dializator wysokoprzepływowo, heliksonowy, o powierzchni czynnej 2,2m, z klirensem fosforanów 253 przy QB 300mL/min [symbol FX100classix] do wykonywania hemodializ?

Odp.

1. Dopuszcza dializator niskoprzepływowo, heliksonowy, o powierzchni czynnej 1,8m, z klirensem fosforanów 210 przy QB 300mL/min [symbol FX10]

2. Dopuszcza dializator wysokoprzepływowo, heliksonowy, o powierzchni czynnej 1,8m, z klirensem fosforanów 244 przy QB 300mL/min [symbol FX80classix] do wykonywania hemodializ

3. Nie dopuszcza dializator wysokoprzepływowo, heliksonowy, o powierzchni czynnej 2,2m, z klirensem fosforanów 253 przy QB 300mL/min [symbol FX100classix] do wykonywania hemodializ

IV.

1. Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy Zamawiający wymaga, aby w Zadaniu 1 w zestawie z liniami krwi znajdował się łącznik do recyrkulacji?

ODP. Nie wymaga a dopuszcza takie rozwiązanie.

2. Czy Zamawiający w zakresie Zadania 2 dopuści dializatory niskoprzepływowe, sterylizowane parą wodną z błoną Polyamix:

Poz.1 – dializator o powierzchni 1,8 m², klirens fosforanów przy Qb=300 ml/min wynosi 230 ml/min;

Poz.2 oraz 3 – dializator o powierzchni 2,1 m², klirens fosforanów przy Qb=300 ml/min wynosi 246 ml/min;

Pozwoli to większej ilości oferentów na złożenie oferty, co skutkować będzie lepszym stosunkiem jakości produktów do zaproponowanej ceny.

Odp: Zamawiający dopuszcza zaproponowane dializatory.

3. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do Zadania 7 „Kapsuły z koncentratem suchym węglanowym” w pełni kompatybilnych Kapsuł wodorowęglanowych o masie 650g ewentualnie 750 g? W przypadku pozytywnej odpowiedzi Zamawiający otrzyma więcej niż jedną ofertę cenową w ramach Zadania 7, co pozwoli podnieść konkurencyjność ofert cenowych.

Odp: Dopuszcza

V.

Pakiet 2

Pyt. 1 – Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2 poz. 1 dializator niskoprzepływowo polieterosulfonowy o powierzchni czynnej 1,8m, z klirensiem fosforanów 239 przy QB 300mL/min?

Zgoda Zamawiającego umożliwi naszej firmie udział w postępowaniu i zaoferowanie wysokiej jakości dializatorów stosowanych w Prywatnych Stacjach Dializ oraz Szpitalach Klinicznych i Specjalistycznych w kraju.

Odp: Dopuszcza

IV

Zadanie 5, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowego zestawu do dializy, dwudzielnego (opakowanie miękkiej blister „dwupak” z perforacją), o składzie:

Rozpoczęcie:

2 szt - rękawice nitrylowe, bezpudrowe roz. M

6 szt - kompresy włókninowe 4W 7,5 cm x 7,5 cm 30g/m²

1 szt - serweta 50 cm x 35 cm 45g/m² dwuwarstwowy laminat (włóknina PP + folia PE)

4 szt - taśma włókninowa 2,5 cm x 15 cm

2 szt - opatrunek do kaniul 5,8 cm x 8 cm (osobno opakowany)

Zakończenie:

1 szt - rękawica nitrylowa, bezpudrowe roz. L biała dla pacjenta

2 szt rękawice nitrylowe, bezpudrowe roz. M

4 szt kompresy włókninowe 4W 7,5 cm x 7,5 cm 30g/m²

2 szt opatrunek z wkładem chłonnym 5 cm x 7,2 cm (osobno opakowany)?

Odp: Zgodnie z SWZ.

Zadanie 5, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowego zestawu do dializy w opakowaniu typu miękkiej blister (rozpoczęcie i zakończenie pakowane oddzielnie) o składzie:

Rozpoczęcie:

2 szt - rękawice nitrylowe, bezpudrowe roz. M

4 szt - kompresy włókninowe 4W 7,5 cm x 7,5 cm 30g/m²

1 szt serweta 50 cm x 35 cm 45 g/m² dwuwarstwowy laminat (włóknina PP + folia PE)

2 szt opatrunek do kaniul 5,8 cm x 8 cm (osobno opakowany)

2 szt taśma włókninowa 2,5 cm x 15 cm

Zakończenie:

1 szt - rękawica nitrylowa, bezpudrowe roz. L biała dla pacjenta

2 szt rękawice nitrylowe, bezpudrowe roz. M

6 szt kompresy włókninowe 4W 7,5 cm x 7,5 cm 30g/m²

2 szt opatrunek poiniekcyjny puchnący 3,8 cm x 7,2 cm foliowy, przezroczysty (osobno opakowany)?

Odp: Zgodnie z SWZ.

VII.

1. Czy zamawiający w Zadaniu 9 dopuści cewniki Arrow o parametrach:

Cewnik permanentny do hemodializy, poliuretanowy, światło cewnika symetryczne,

podzielone spiralnie, z otworami bocznymi 15F, długość całkowita: 190 do 310 mm(skok co 4cm), mufka do podłączenia zestawu wymiennego, kompletny zestaw do implantacji?

Odp: Dopuszcza.

VIII

1. Czy Zamawiający w pozycji 1 zadanie 9 do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy poliuretanowy Evolution Flow do implantacji metodą wsteczną (retrograde) z opatentowaną konstrukcją

końcówki, która umożliwi proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsiionku, o stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR, ramiona proste i długości: 19/40 cm, 23/44 cm, 28/49 cm, 33/54 cm do wyboru przez Zamawiającego?

Charakterystyka zestawu:

- radiocieniujący cewnik
- silikonowe ramiona
- złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia chemiczne i mechaniczne
- zacisk na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- adapter wypełniający
- zacisk cewnika ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło 12 Fr
- rozszerzadło 16 Fr z rozrywalną koszulką
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- kleszczyki – 2 szt.

ODP Dopuszcza

IX

1. Pytanie nr 1 dotyczy Zadania nr 5 poz. 1:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji jałowego zestawu do dializy - rozpoczęcie i zakończenie oddzielnie pakowane.

Rozpoczęcie dializy - skład:

- Kompresy włókninowe z bawełny, 7,5x7,5cm, 4 warstwy, klasa I reguła 4, gramatura 30g/m² – 4 szt.
- Przylepiec włókninowy, biały na kleju akrylowym 2x15cm – 2 szt.
- Serweta z laminatu celulozowo-polietylenowego, 50x35cm, niebieska, gramatura 41 g/m² – 1 szt.
- Opatrunek do mocowania kaniul 6x8cm – 2 szt.
- Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, teksturowane, rozmiar M, kolor niebieski – 2 szt.

Zakończenie dializy - skład:

- Kompresy włókninowe z bawełny, 7,5x7,5cm, gramatura 30 g/m², 4 warstwy – 4szt.
- Opatrunek tamujący krwawienie typu Pushban 3,8x7,2cm – 2 szt.
- Rękawice nitrylowe, bezpudrowa, teksturowane, M – 2 szt., niebieskie
- Rękawica nitrylowa, bezpudrowa, teksturowana, L – 1 szt., biała

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowany zestaw do dializy.

Pytania do wzoru umowy:

Wnosimy o wykreślenie § 6 projektu umowy. UZASADNIENIE: Zgodnie z art. 552 ustawy Kodeks Cywilny w zw. z art. 8 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Praw zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) celem przepisu zawartego w Kodeksie Cywilnym, który zgodnie z poglądem doktryny stanowi *lex specialis* w stosunku do art. 490 KC (S. Buczkowski, w: Komentarz KC, t. II, 1972, s. 1281; C. Żuławska, w: Komentarz do KC, Ks. III, t. II, 2011, s. 50–51; Z. Gawlik, w: Kidyba, Komentarz KC, t. III, cz. 2, 2014, s. 93; Z. Banaszczyk, w: Pietrzykowski, Komentarz KC, t. II, 2015, s. 298; J. Jezioro, w: Gniewek, Machnikowski, Komentarz KC, 2014, s. 1112; wyr. SA w Szczecinie z 9.10.2013 r., I ACa 364/13) jest minimalizacja ryzyka po stronie Wykonawcy zobowiązanego do wcześniejszego spełnienia świadczenia, zaś zwłoka Zamawiającego w zapłacie ceny jest efektem naruszenia przez niego podstawowego obowiązku zapłaty ceny, wynikającego z art. 535 KC. Mając powyższe na uwadze niezasadnym wydaje się przystanie przez Wykonawcę na propozycję ograniczenia jego uprawnienia.

Odp. Zamawiający nie wymaga i nie narusza prawa Wykonawcy za nie terminową płatność. Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.(Pomimo to Zamawiający w tym § zmienia liczbę „7” na liczbę „1”)

X.

Pytania do pakietu 9

Pytanie 1

Zamawiający w pakiecie 9 umieścił opis produktu charakterystycznego dla firmy Medtronic . Jednocześnie na stronie URLiP pod linkiem: https://urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Medtronic_2022_06_FA1244.pdf widnieje informacja , że produkty o które ubiega się Zamawiający zostały wycofane z obrotu .

Czy Zamawiający mając na względzie zasadę efektywności i konkurencyjności, oraz z uwagi na kryteria ceny ofert gdzie cena stanowi 60%, termin dostawy 20%, termin płatności 20%, dopuści cewnik o niewielkich różnicach technicznych, lecz o lepszej funkcjonalności:

Zestaw dializacyjny permanentny (stały) 15,5F (mieszczący się w zakresie cewników permanentnych 14,5F-16F) wykonany w technologii typu ENDEXO – materiał odporny na odkładanie się skrzepin. Zestaw w skład którego wchodzi między innymi cewnik dwuświatłowy - kształt wlotu zakrzywiona końcówka (curved tip);Długość mierzona jako odległość mufka-koniec cewnika (Cuff to tip), Pakowane pojedynczo.

- zakończony niesymetrycznie, różnica 3cm między kanałem żylnym a tętnicznym zmniejsza stopień recyrkulacji,
- końcówka cewnika odgięta, zmniejsza ryzyko przylegania do ściany i zakrzepicy,
- osobny kanał dla przewodnicy ułatwiający wprowadzenie cewnika do żyły,
- posiada mufkę poliesterową umożliwiającą optymalne wrastanie tkanki,
- wykonany w innowacyjnej technologii Endexo, co sprawia, że materiał cewnika jest bardziej odporny na gromadzenie się elementów krwi w porównaniu do standardowych cewników niepowlekanych,
- końcówki luerowskie wykonane z termoplastycznego poliuretanu

Zestaw: Igła wprowadzająca 18 Ga x 7 cm, Prowadnica J, Skalpel nr 11, Rozszerzacz żył: 12 Fr i 14 Fr, Prowadnik rozdzielny 16 Fr z automatyczną zastawką hemostatyczną minimalizującą ryzyko zatoru powietrznego i krwawienia przy wprowadzaniu cewnika, Bagnet do tunelizacji, Opatrunek samoprzylepny, Nasadki iniekcyjne Oferujemy długości do mufy: 19 cm; 23 cm; 27 cm; 31 cm; 35cm.

Katalog produktu w załączeniu.

Pytanie 2

Jeśli Zamawiający utrzyma parametry wykluczające kierując się tylko własną chęcią posiadania konkretnego produktu, i nie stworzył warunków do składania ofert większej ilości wykonawców, zgodnie z zasadą konkurencyjności i z wykorzystaniem norm rekomendowanych w polityce zakupowej państwa i nie zastosuje się do nich w oparciu o obiektywne potrzeby społeczne, prosimy o wskazanie granic równoważności i zasad konkurencyjności w oparciu o artykuł 99 ust. 4-6 PZP

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowany zestaw.

Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część załączników i zapisów SWZ

Pismo w dniu dzisiejszym zostaje zamieszczone na stronie internetowej [https:// www.zoz.konskie.pl](https://www.zoz.konskie.pl) ,
<https://miniportal.uzp.gov.pl/>

Sporządził,
Inspektor
ds. Zamówień Publicznych
mgr Anna Drabik

Z-ca Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Końskich
mgr inż. Jerzy Grodzki